


Kasutusjuhend



18ch T/R põlvemähis

GE 3.0T MRT-süsteemidele

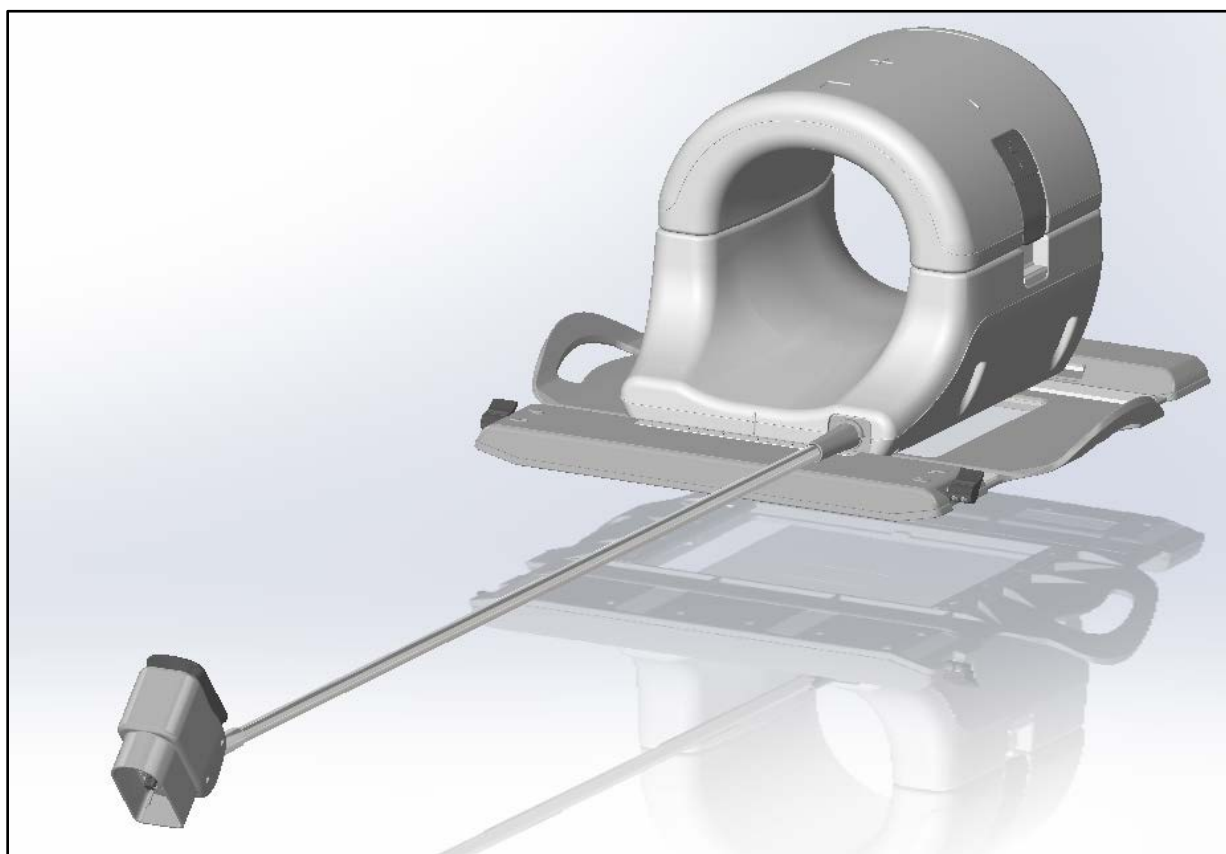

REF Mudeli number:

GE	QED
5561409-2	Q7000074

Garantii ja vastutus

Pärast kauba kätte saamist lasub vastutus toote hooldamise ja käsitlemise eest kliendil, kes on toote ostnud. Garantii ei kehti isegi mitte garantiiajal järgmistel juhtudel.

- Kahjustus või ilma jäämine väärkasutuse või kuritarvitamise tõttu.
- Kahjustus või ilma jäämine vääramatute loodusjõudude tagajärjel (tulekahjud, maavärinad, üleujutused, pikselööd jms).
- Kahjustus või ilma jäämine, mis tuleneb mittevastavusest nimetatud seadmele sätestatud konkreetsetele tingimustele, nt ebapiisav toide, vale paigaldus või vastuvõetamatud keskkonnatingimused.
- Kahjustus tootele tehtud muudatuste või täiustuste tõttu.

QED ei vastuta mitte ühelgi juhul järgmistel juhtudel.

- Kahjustus, ilma jäämine või probleemid, mida põhjustab ümberpaigutamine, modifitseerimine või remontimine, mida ei ole läbi viinud QED otseselt volitatud töötajad.
- Kahjustus või ilma jäämine, mida põhjustab käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate ettevaatusabinõude ja kasutusjuhiste tähelepanuta jätmine või eiramine.

Transportimis- ja säilitamistingimused

TEATIS. SEDA SEADET TULEB TRANSPORTIDA JA SÄILITADA JÄRGMISTES TINGIMUSTES.

1. Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik -40 °C...+70 °C
2. Suhtelise niiskuse vahemik 10%...100%
3. Atmosfäärirõhu vahemik 50 kPa...106 kPa



Volitatud esindaja Euroopas:



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Haag
Madalmaad

Ameerika Ühendriikide föderaalseadus

Ettevaatust! Föderaalseadused lubavad seda seadet müüa, levitada ja kasutada ainult arstil või arsti tellimusel. See seade on piiratud föderaalseadustega uuringutel kasutamiseks eesmärkidel, mida ei ole kasutusnäidustustes välja toodud.

Väljaandmiskuupäev: 2020-06

Sissejuhatus

Käesolev juhend sisaldab üksikasjalikku teavet 18ch T/R põlvemähise ohutusnõuete kohta seadme kasutamisel ja hooldamisel. Käesoleva toote ohutuks ja täpseks kasutamiseks lugege nii seda juhendit kui ka MRT-süsteemi kasutusjuhendit enne toote kasutamist. See juhend ei sisalda juhiseid ega ohutusteavet nende seadmete kohta, mida QED ei ole tarninud. Teabe saamiseks mitte QED seadmete kohta pöörduge vastava originaalseadme tootja poole.

Ühilduvus

18ch T/R põlvemähis ühildub GE 3.0T MRT-süsteemidega.

Kasutajaprofiil

Operaator – radioloogiatehnikud, labori tehnikud, arstid (pidage siiski meeles, et järgida tuleb kõiki asjaomases riigis kehtivaid seadusi).

Kasutaja väljaõpe – selle mähise kasutamiseks ei ole vaja läbida spetsiaalset väljaõpet (GE pakub siiski üldist väljaõppekursust MRT-süsteemide kasutamise kohta, et anda operaatoritele MRT-süsteemide õigeks kasutamiseks juhiseid).

Teave patsiendile

Vanus, tervis, seisund – eripiirangud puuduvad


Kaal – 250 kg või vähem (lugege MRT-süsteemi kasutusjuhendit ja kui patsiendi maksimaalne lubatud kaal süsteemi jaoks on väiksem kui selle mähise jaoks, tuleb anda eelis süsteemi maksimaalsele kaalule).

Sisukord

Sissejuhatus.....	3
Ühilduvus	3
Kasutajaprofiil	3
Teave patsiendile	3
Sisukord.....	4
Peatükk 1 – 18ch T/R põlvemähise osad	5
Peatükk 2 – Ohutus.....	6
Sümbolid	6
Näidustused	7
Vastunäidustused.....	7
Ettevaatusabinõud	7
Ettevaatust RF-mähisega	7
Protseduurid erakorralise olukorra tekkimisel	9
Peatükk 3 – TR-pordi asukoht	10
TR-pordi asukoht.....	10
Peatükk 4 – Kvaliteedi tagamine.....	10
Skanneri vastavustõendamine	10
Signaali-müra suhte (SNR) katse	10
Mitmemähiseline kvaliteedikontrolli vahend (MCQA)	15
MCQA vaaturi kasutamine	18
Peatükk 5 – Mähise seadistamine ja kasutamine	20
18ch T/R põlvemähise paigutamine patsiendi lamamisalusele	20
Padja paigutus.....	22
Patsiendi paigutamine	24
Mähise lukustamine	25
Tähistamine.....	26
Peatükk 6 – Puhastamine, hooldus, teenindus ja kasutuselt kõrvaldamine	27
RF-mähise puhastamine.....	27
Hooldus	28
Teenindus.....	28
Kasutuselt kõrvaldamine.....	28

Peatükk 1 – 18ch T/R põlvemähise osad

18ch T/R põlvemähis tarnitakse koos allpool näidatud osadega. Kättesaamisel veenduge palun, et saadeti sisaldaks kõiki osi.

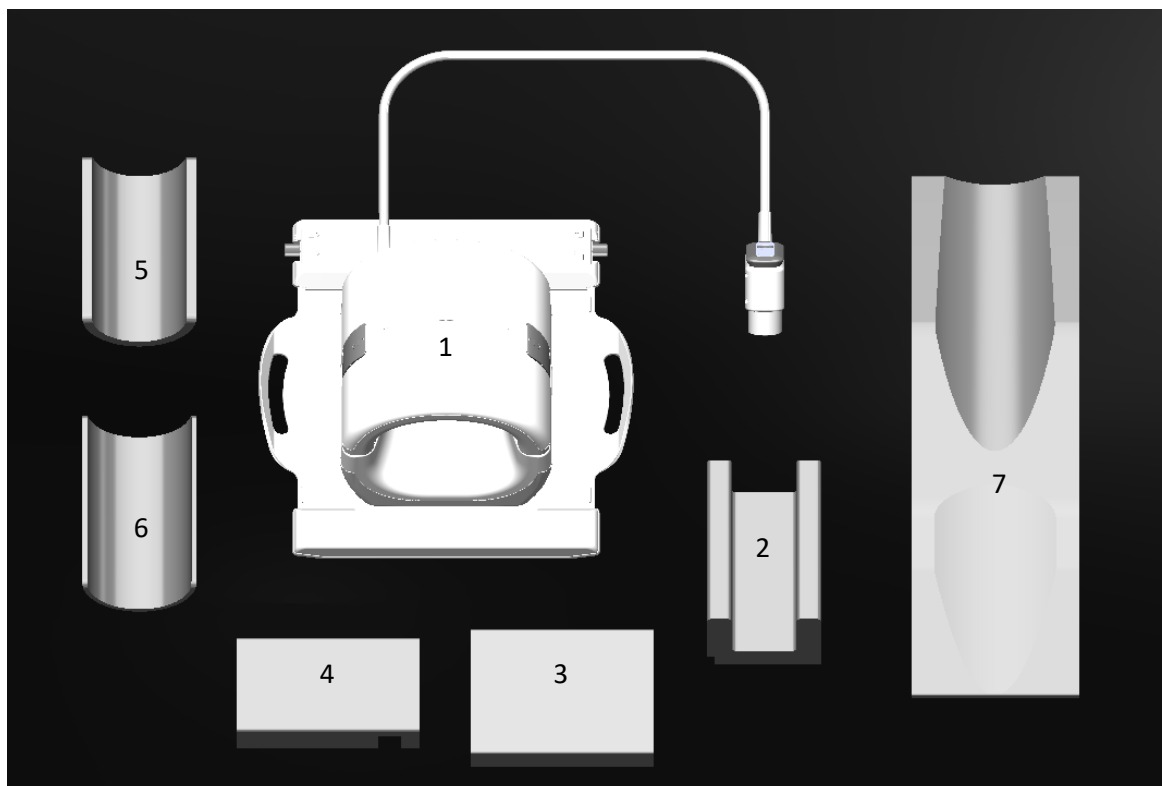

Number	Kirjeldus	Kogus	GE osa nr	QED osa nr
1	18ch T/R põlvemähis	1	5561409-2	Q7000074
2	T/R põlvemähise jalapadi	1	5561409-7	3003887
3	T/R põlvemähise reie tugipadi	1	5561409-10	3003863
4	T/R põlvemähise säärepadi	1	5561409-11	3003896
5	T/R põlvemähise alumine padi, 0,5 tolli (0,64 cm)	1	5561409-8	3003885
6	T/R põlvemähise alumine padi, 0,25 tolli (0,64 cm)	1	5561409-9	3003884
7	T/R põlvemähise padi, põlv ei ole pildil näidatud	1	5561409-6	3003888

Toote kogukaal: 7,5 kg (16,5 naela)

Peatükk 2 – Ohutus

Selles peatükis kirjeldatakse üldiseid ettevaatusabinõusid ja ohutusalast teavet, mida tuleb käesoleva mähise kasutamisel jälgida.

MRT-süsteemi kasutamisel lugege ka MRT-süsteemi kasutusjuhendis kirjeldatud ettevaatusabinõusid.

Sümbolid

Sümbol	Number	Standard	Pealkiri, tähendus
	0434A	ISO 7000 IEC 60417	Ettevaatust, seadme kasutamisel on vaja olla ettevaatlik ja/või kirjeldatud olukord nõuab kasutaja teadlikkust või kasutaja toimingut, et vältida soovimatuid tagajärgi
	1641	ISO 7000 IEC 60417	Kasutusjuhend, lugege kasutusjuhendit enne seadme kasutamist
	5172	ISO 7000 IEC 60417	II klassi seade
	5333	ISO 7000 IEC 60417	BF-tüüpi rakendusdetail
	3082	ISO 7000 IEC 60417	Tootja
	2497	ISO 7000 IEC 60417	Tootmise kuupäev
	6192	ISO 7000 IEC 60417	Raadiosageduslik pool, saatmine ja vastuvõtmine
	5.1.2	ISO 15223-1	Volitatud esindaja Euroopa Liidus
	2493	ISO 7000 IEC 60417	Katalooginumber
	2498	ISO 7000 IEC 60417	Seerianumber
	pole kättesaadav	pole kättesaadav	ETL-i loendis (Kanada ja USA)
	0632	ISO 7000 IEC 60417	Temperatuuripiirang
	2620	ISO 7000 IEC 60417	Niiskuspierang
	2621	ISO 7000 IEC 60417	Atmosfäärirõhu piirang

Sümbol	Number	Standard	Pealkiri, tähendus
	W017	ISO 24409-2 ISO 8528-13	Hoiatus; kuum pind
	pole kättesaadav	EN50419 EU2012/18/EU	Selle sümboli kasutamine näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmetena. Kui tagate selle toote jäätmete nõuetekohase käitlemise, aitate kaasa võimalike keskkonna- ja inimeste tervisekahjude tõkestamisele, mida võib põhjustada selle toote sobimatu jäätmekäitlus. Täpsemat teavet selle toote tagastamise ja ringlussevõtu kohta saate hankijalt, kellelt toote ostsite.

Näidustused

18ch T/R põlvemähis on ette nähtud kasutamiseks GE 3.0T MR-süsteemidega, et teha põlvest diagnostilisi ülesvõtteid, mida väljaõppinud arst saab tõlgendada.

Vastunäidustused

Puuduvad.

Ettevaatusabinõud



Patsiendid, kellel on suurem tõenäosus krampide või klaustrofoobia tekkeks.



Patsiendid, kes on teadvusetud, väga tugevasti uinutatud või segasusseisundis.



Patsiendid, kes ei suuda säilitada usaldusväärset suhtlemist (nt imikud või noored lapsed).



Patsiendid, kelle mis tahes kehaosa on tundetu.



Patsiendid, kellel võib olla raske säilitada kehatemperatuuri või kes on eriti tundlikud kehatemperatuuri tõusu suhtes (nt palavikuga, südamerikkega või hingamiskahjustusega patsiendid).

Ettevaatust RF-mähisega



Ärge pange skannimise ajal portaali ühtegi lahtiühendatud seadet (RF-mähised, kaablid jms).



Ühendage RF-mähise ühendusporti ainult määratud RF-mähiseid.



Ärge kasutage defektset RF-mähist, eriti siis, kui väline kate on kahjustatud või kui metallosad on nähtaval.



Ärge püüdke mähist muuta ega täiustada.





Ärge kaableid ristake ega lingu siduge.



Veenduge, et patsient ei puutuks otseselt kokku mähise kaablitega.



Ärge lubage patsiendil ühegi kehaosaga suletud ahelat moodustada. Kasutage patju tagamaks, et patsiendi käed ja jalad ei puutu vastu mähist, MRT-süsteemi, patsiendilauda või teist kehaosa, mille tulemusena võib moodustuda ling.

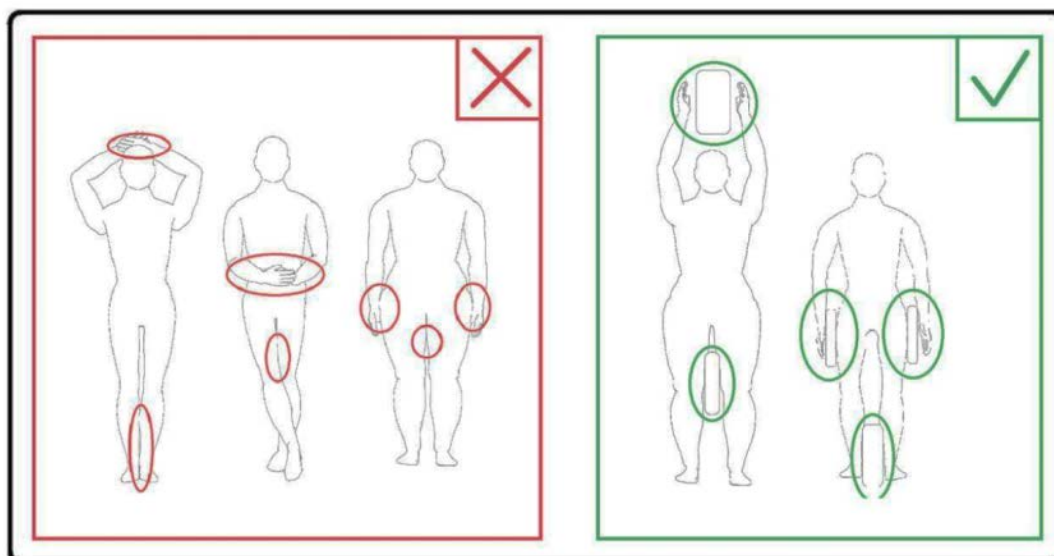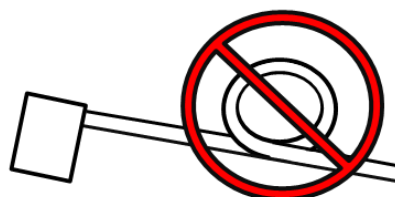

Ärge laske patsiendil ega RF-poolil ühegi MRT-süsteemi osa vastu puutuda. Vajaduse korral kasutage patju, et eraldada patsient avause seintest.



Peatage skannimine kohe, kui patsient kurdab soojenemis-, kipitamis-, torkimis- vms tunde üle. Enne skannimise jätkamist konsulteerige arstiga.



Veenduge, et mähis ei puutuks kokku vedelikega, nt vee või ravimitega.



Kui leiате, et mähis on defektne, lõpetage mähise kasutamine kohe ja pöörduge GE kohaliku esindaja poole.



Kasutage koos mähisega ainult käesolevas juhendis kirjeldatud lisatarvikuid.

Protseduurid erakorralise olukorra tekkimisel

Kui skannimise ajal tekib erakorraline olukord, peatage skannimine kohe, eemaldage patsient ruumist ja andke vajaduse korral meditsiinilist abi.

Kui leiab aset tõsine juhtum, peaksite sellest teatama tootjale ja selle liikmesriigi pädevale institutsioonile, kus kasutaja ettevõtte asub.

Peatükk 3 – TR-pordi asukoht

TR-pordi asukoht

18ch T/R põlvemähis on saatjaga ja vastuvõtjaga mähis. Mähise õigeks kasutamiseks veenduge, et süsteemi liidese pistik oleks ühendatud õigesse pessa. Vaadake süsteemi kasutusjuhendist, milline pesa toetab nii saatmist kui ka vastuvõtmist.

Peatükk 4 – Kvaliteedi tagamine

Skanneri vastavustõendamine

Tehke süsteemi taseme signaali-müra suhte (SNR) katse. Vt CD-d Service Methods (Hooldusmeetodid); jaotisi Süsteemi taseme protseduurid; Funktsionaalne kontrollimine; Signaali-müra suhte (SNR) katse.

Signaali-müra suhte (SNR) katse


Nõutavad tööriistad/kinnitusvahendid

Kirjeldus	GE osa nr	QED osa nr	Kogus
Suur silindriline ühtne fantoom, SiOil	5342679-2	pole kättesaadav	1
T/R põlvemähise alumine padi, 0,5 tolli (0,64 cm)	5561409-8	3003885	1


Mähise ja fantoomi seadistamine

1. Salvestage nii kasutatava(te) mähis(t)e seerianumber kui ka tarkvara järkversioon (suvandist testrecord või getver).
2. Eemaldage lamamisaluselt kõik teised pinnamähised (kui need on olemas).


3. Viige põlvemähis patsiendi lamamislusele. Hoidke kindlasti kahe käega kinni mähise raamil olevast käepidemest.

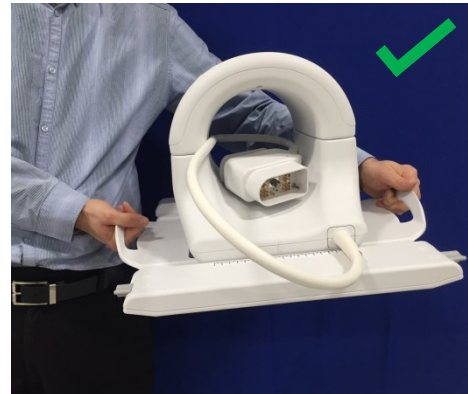


4. Paigutage mähis patsiendi lamamislusele. Pidage meeles, et allpool näidatud avause suunanool peab osutama avause **poole**.

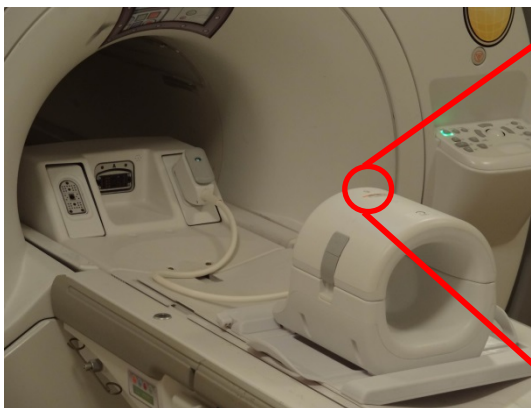


- Ühendage mähise konnektor süsteemi asjakohase saatjapordiga. (Vt TR-pordi asukohta süsteemi kasutusjuhendist). Keerake P-pordi konnektori ots nii, et see näitab LUKUSTATUD asendit, vt parempoolselt pildilt.

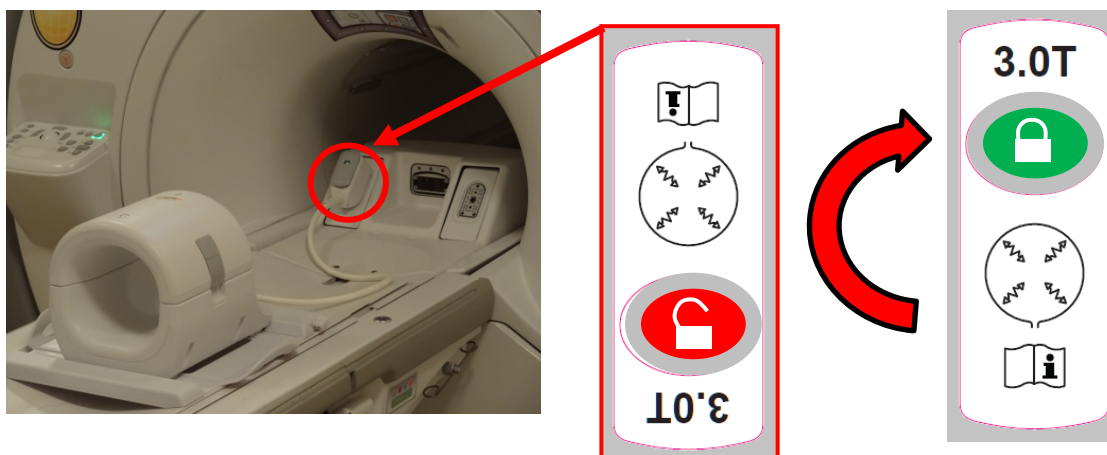

- Veenduge, et mähise vasak-parem asend oleks raami keskel. Kui reguleerimine on vajalik, pöörake mähise raamil olevat nuppu mähise avamiseks ja liigutage mähis soovitud asendisse.

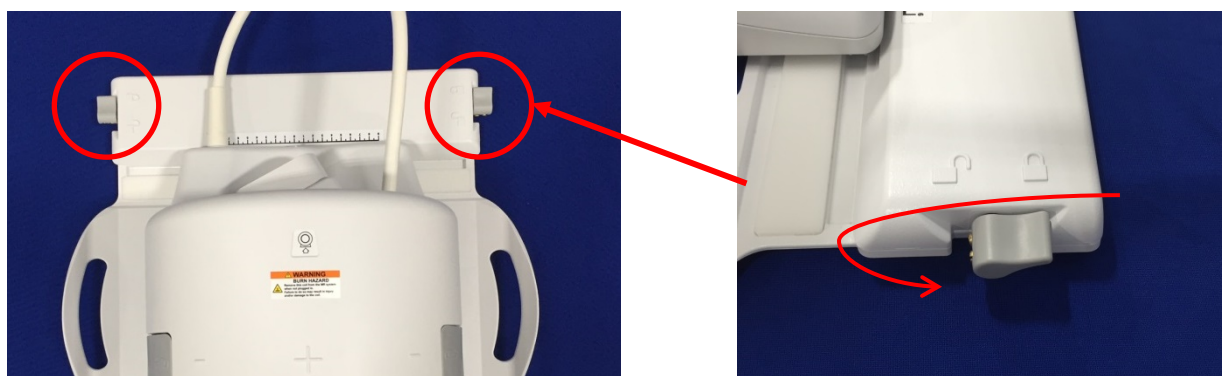

- Kui mähis on jõudnud soovitud asendisse, pöörake nupp mähise kohale kinnitamiseks jälle lukustatud asendisse.

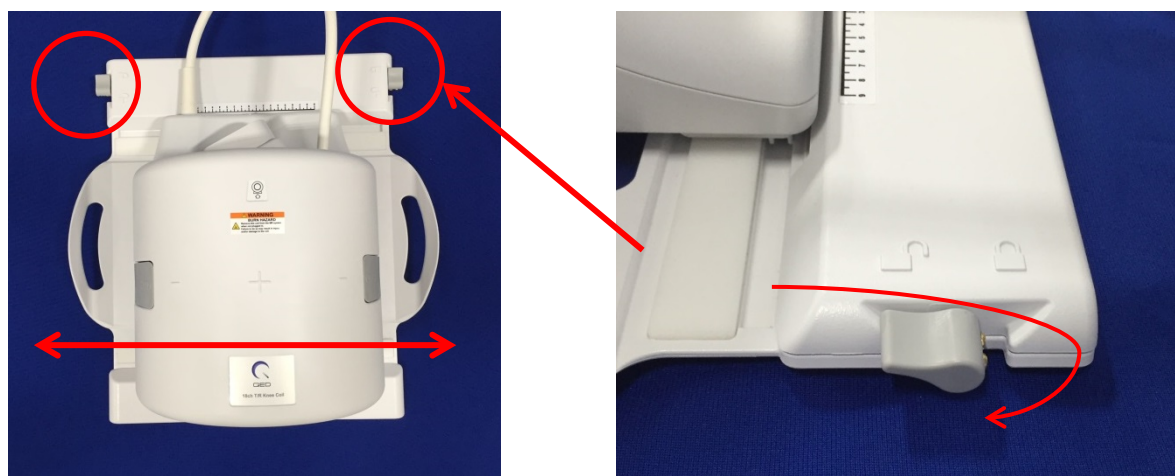



8. Eraldage eesmine mähis, tõmmates mõlemat riivi klappi samaaegselt, kuni kaks poolt on üleni teineteisest lahutatud.



9. Paigutage 18ch T/R põlvemähise alumine padi (0,5 tolli (1,27 cm)) (5561409-8) ja suur silindriline ühtne fantoom, SiOil (5342679-2) mähisele, nagu on näidatud allpool.





10. Taasühendage eesmise mähise pool. **Veenduge, et mõlemad pooled oleksid täielikult suletud ja riivi klapid oleksid sisse surutud.**

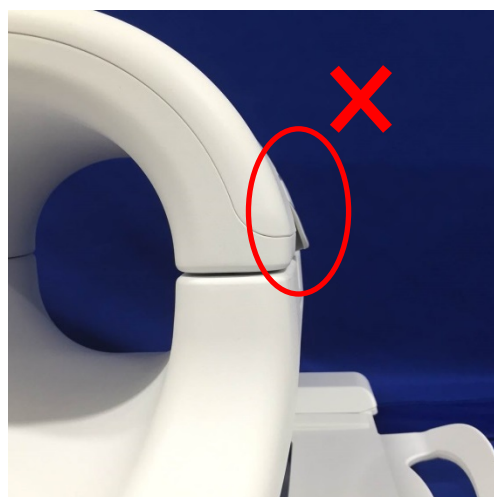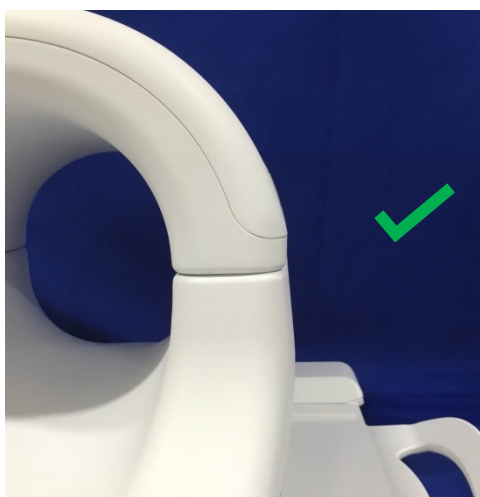

Ettevaatust! Olge ettevaatlik, et sõrmed ei satuks riivi alla. Hoidke kinni ainult juurdepääsetavatest klappidest, nagu on näidatud eespool oleval pildil.

11. Tähistage mähis allpool näidatud märgiste juures ja viige mähis avausse.

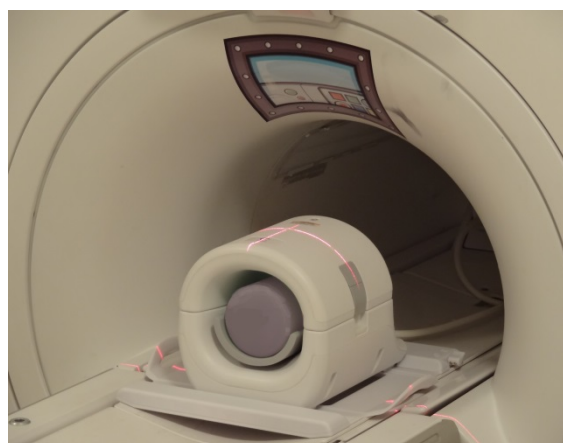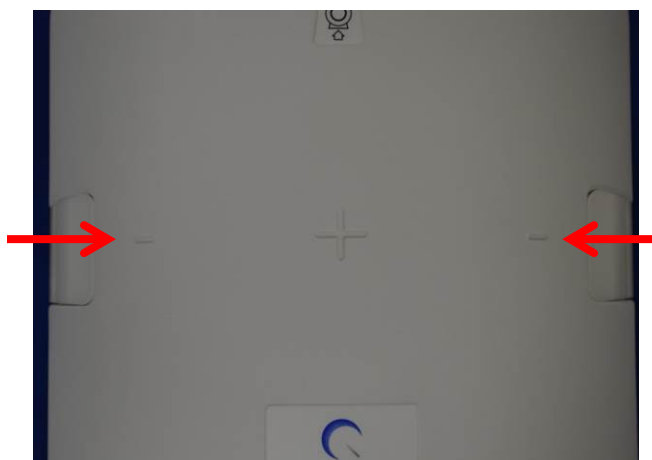


Mitmemähiseline kvaliteedikontrolli vahend (MCQA)

Kõik RF-mähisega seotud testid tuleb läbi viia korralikult kalibreeritud süsteemiga. EPIWP (valge piksel spetsifikatsioonide installeerimisest) peab olema läbitud.

Testi ID	Parameetri kirjeldus	Oodatud tulemus
1	EPIWP spetsifikatsioonides	PASS (LÄBITUD)


MCQA käivitamiseks tehke järgmist.

1. Minge aknast Common Service Desktop (CSD) (Üldine teeninduse töölaud) lehitsejasse Service Browser (Teeninduse brauser) ja valige suvand [Image Quality] (Kujutise kvaliteet) “Multi-Coil QA Tool” (Mitmemähiseline kvaliteedikontrolli vahend) ning seejärel “Click here to start this tool” (Klõpsa tööriista käivitamiseks siia), nagu on näidatud joonisel 1.

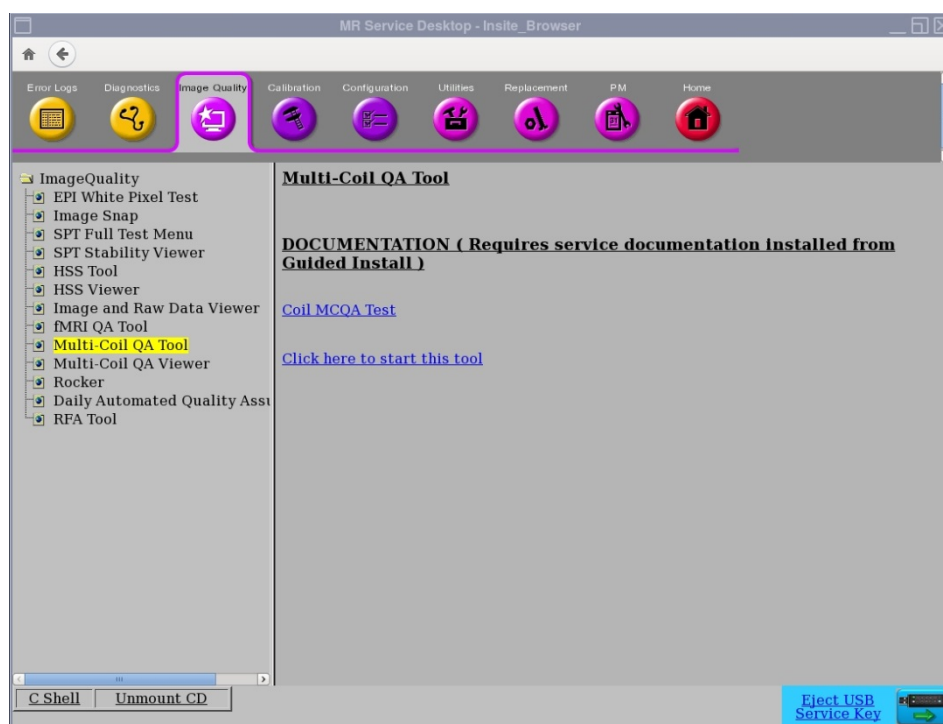

Joonis 1


Märkus. Kui hoiatust „No valid MCR-V (or MCR2/3)” (kehtiv MCR-V (või MCR2/3 puudub)) (joonis 2) ei kuvata, valige [Yes] (Jah) ning jätkake testi. MCR-V diagnostika tuleb sooritada enne süsteemi üleandmist kliendile.

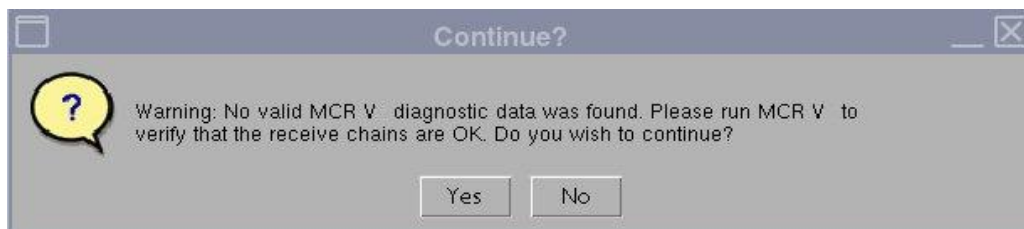

Joonis 2


Hetkel kasutatava mähise väli täidetakse automaatselt (joonis 3) LPCA-ga ühendatud mähise ID kohaselt. Sisestage testitava mähise seerianumber väljale Coil Serial # (Mähise seerianumber).

2. Klõpsake nuppu **[Start]** (Käivita), et alustada automaatset testimist, nagu on näidatud joonisel 3. Olenevalt testitavate asukohtade arvust (mähise keerukus) võib test kesta 3 kuni 5 minutit.

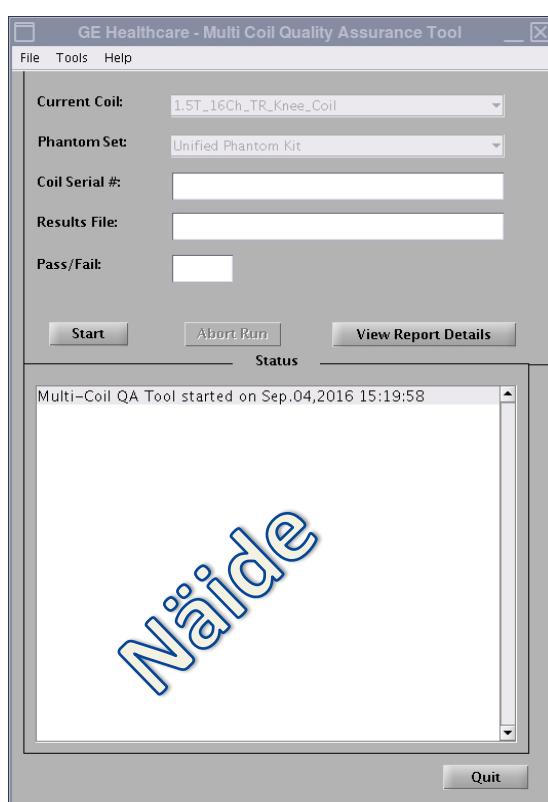


Joonis 3

3. Käivitumisel kuvatakse teade "Phantom placement and coil landmarking are critical for repeatable results" (Fantoomi asendamine ja mähise tuvastav tähistamine on olulise tähtsusega korratavate tulemuste saamiseks). Kui tähistus on pandud õigesti ja fantoomis ei ole õhumulle, klõpsake jätkamiseks nuppu **[Yes]** (Jah). (Joonis 4).

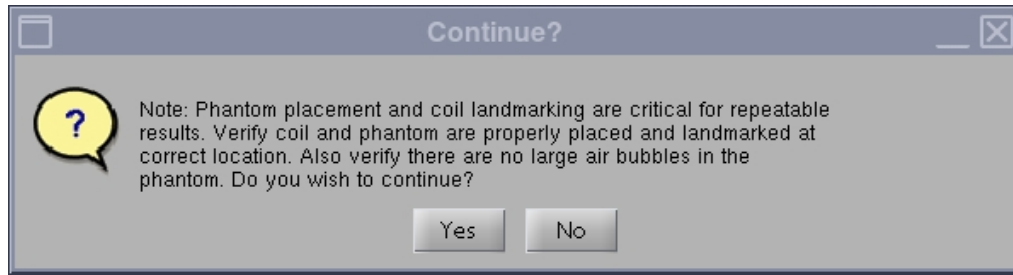

Joonis 4

Märkus. Mitmemähiselise kvaliteedikontrolli vahendi (MCQA) graafilise kasutajaliidese olekuaken uueneb pidevalt, et anda teavet selle kohta, mida tööriist mis tahes ajahetkel teeb. Kuvatakse ajatulp (joonis 5), mis näitab testi ligikaudset kogukestust, möödunud aega ja sooritusprotsenti.

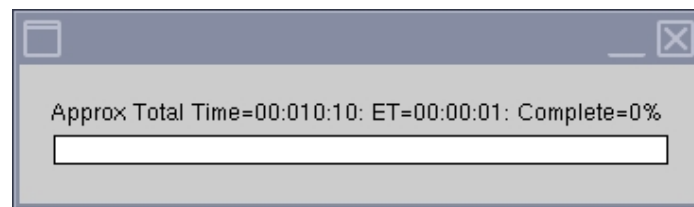


Joonis 5

Kui test on lõppenud, kuvatakse testi tulemused ekraanil (joonis 6). Olek PASS/FAIL (LÄBITUD/NURJUNUD) näitab PASS (LÄBITUD), kui kõik mähise elemendid töötavad nõuetekohaselt. Mitmemähiselise kvaliteedikontrolli vahendi (MCQA) graafiline kasutajaliides kuvab oleku "Fail" (Nurjunud) ühel järgmistest võimalikest põhjustest, kuid mitte ainult nende korral.

- Halb mähise element
- Testiks kasutatud vale fantoom
- Fantoomi vale paigutamine/asend

Rohkem teavet MCQA testi kohta leiate MR-i hooldusmeetodite DVD-lt või veebilehelt järjendiga: Troubleshooting -> System -> Multi-Coil Quality Assurance Tool (Veaotsing -> Süsteem -> Mitmemähiseline kvaliteedikontrolli vahend).

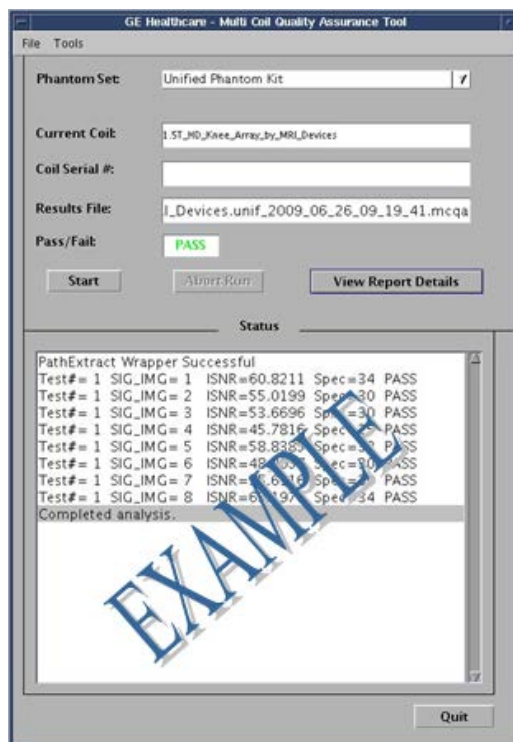

Joonis 6


4. Klõpsake nuppu [Quit] (Katkesta), et MCQA tööriistast väljuda.

MCQA vaaturi kasutamine

Juhul kui tulemusi vaadatakse hilisemas järgus, toimige järgmiselt.

1. Valige MCQA tööriista aknas suvandid File (Fail) ja Open Results File (Ava tulemuste fail) ning valige soovitud mähise tulemuste fail. Tulemuste ülevaatamiseks valige [View Report Details] (Vaata aruande detaile).

Märkus. Tulemuste vaatur avaneb, nagu on näidatud joonisel 7. Tööriista graafilises kasutajaliideses näidatud tulemuste faili nimi ja tulemused Pass/Fail (Läbitud/Nurjunud) loendatakse ka vaaturi ülaosas.

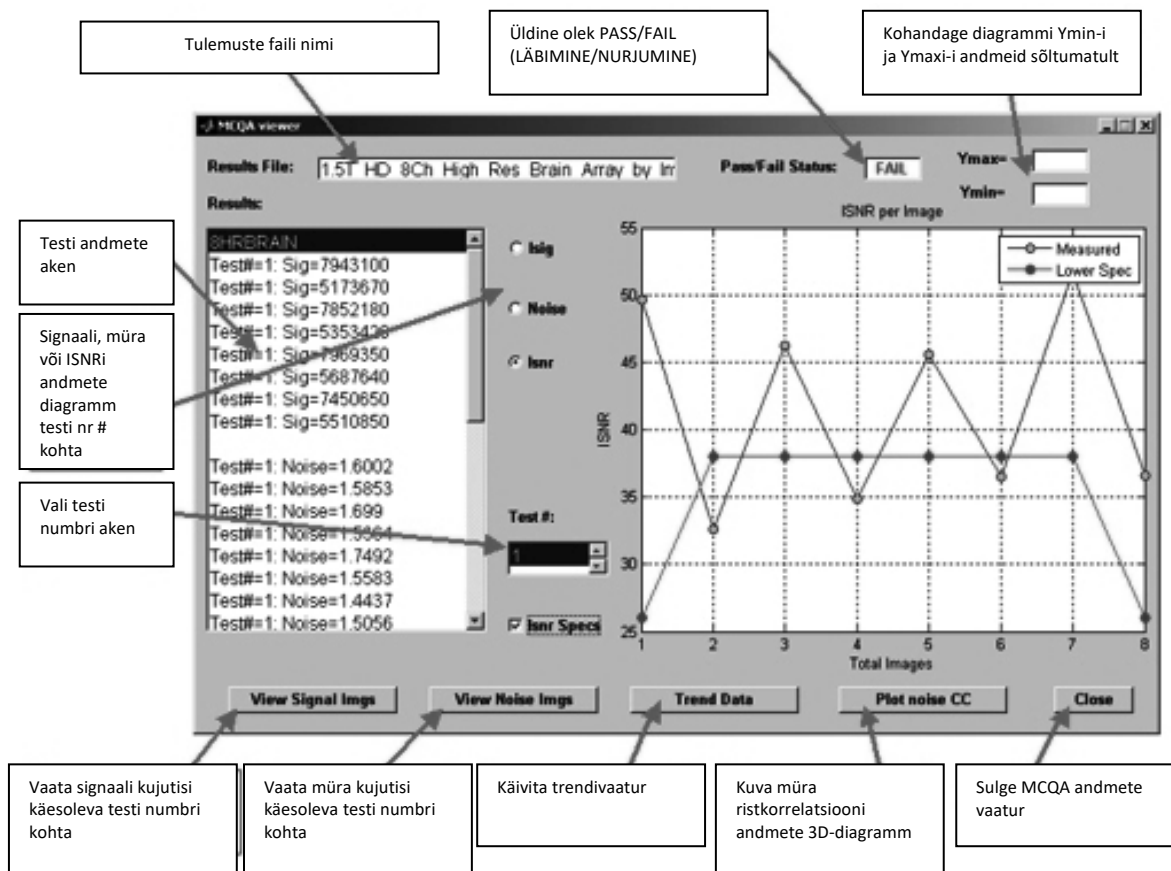

Joonis 7


2. Tulemuste vaatamiseks valige tulemuste vaaturi keskmises osas olevad ISNR-i suvand ja ISNR Specs (ISNR-i spetsifikatsioonid) märkeruut.

Testi ID	Parameetri kirjeldus	Oodatud tulemus
1	EPIWP spetsifikatsioonides	PASS (LÄBITUD)


Peatükk 5 – Mähise seadistamine ja kasutamine

18ch T/R põlvemähise paigutamine patsiendi lamamisalusele


1. Eemaldage patsiendi lamamisaluselt kõik teised pinnamähised (kui need on olemas).
2. Viige põlvemähis patsiendi lamamisalusele. Hoidke kindlasti kahe käega kinni mähise raamil olevast käepidemest.

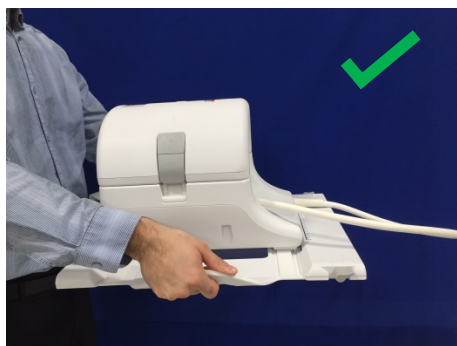


3. Paigutage mähis patsiendi lamamisalusele. Pidage meeles, et allpool näidatud avause suunanool peab osutama avause **poole**.

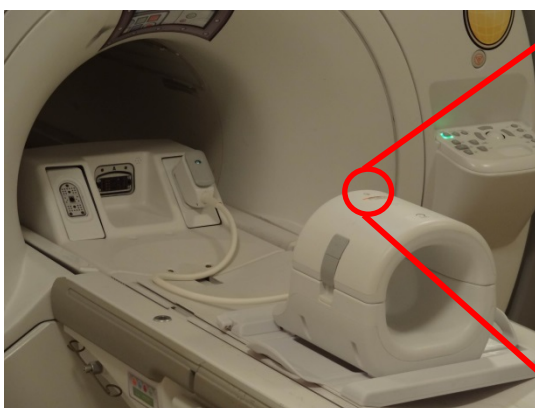


4. Ühendage mähise konnektor süsteemi asjakohase saatjapordiga. (Vt TR-pordi asukohta süsteemi kasutusjuhendist.) Keerake P-pordi konnektori ots nii, et see näitab LUKUSTATUD asendit, vt parempoolselt pildilt.

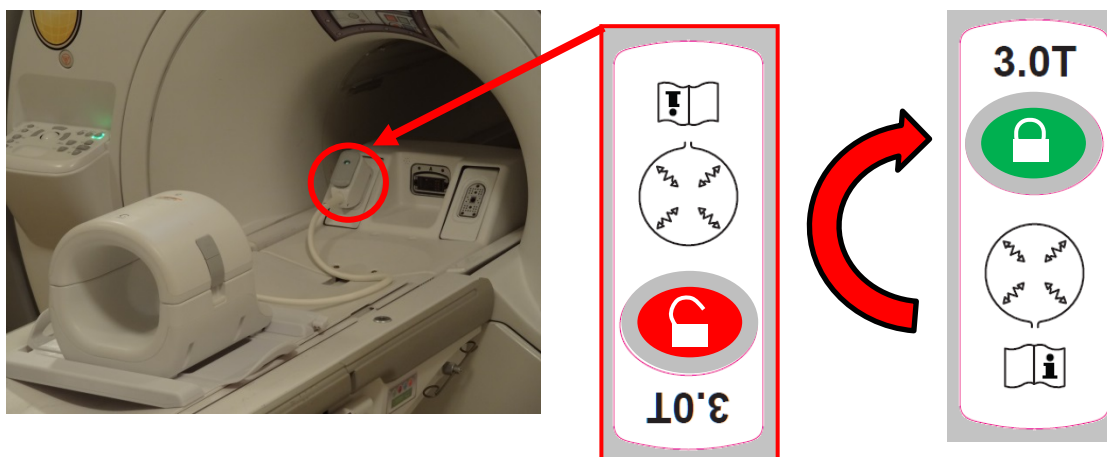

5. Veenduge, et mähise vasak-parem asend oleks raami keskel. Kui reguleerimine on vajalik, pöörake mähise raamil olevat nuppu mähise avamiseks ja liigutage mähis soovitud asendisse.

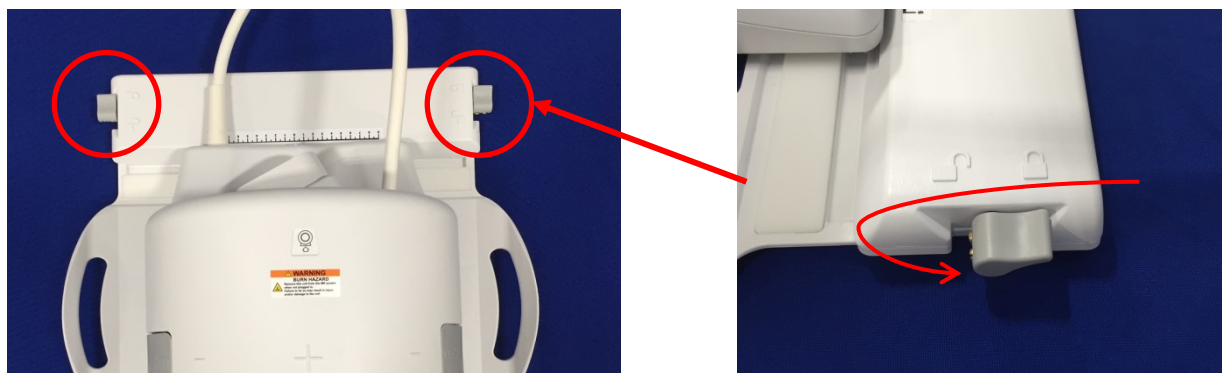

6. Kui mähis on jõudnud soovitud asendisse, pöörake nupp mähise kohale kinnitamiseks jälle lukustatud asendisse.

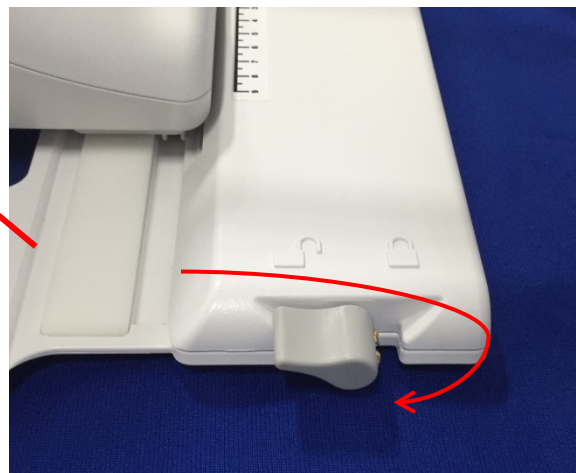


7. Eraldage eesmine mähis, tõmmates mõlemat riivi klappi samaaegselt, kuni kaks poolt on üleni teineteisest lahutatud.



Padja paigutus

18ch T/R põlvemähisega tarnitakse erinevad padjad, et vähendada liikumisest tingitud artefakti ja tagada patsiendile mugavus. Lisaks on mõned padjad isoleerivaks vahendiks patsiendi keha ja


kaabli vahel, et aidata ennetada kaabliühendusest ja/või elektrilistest põletustest tulenevaid mis tahes võimalikke ohte.

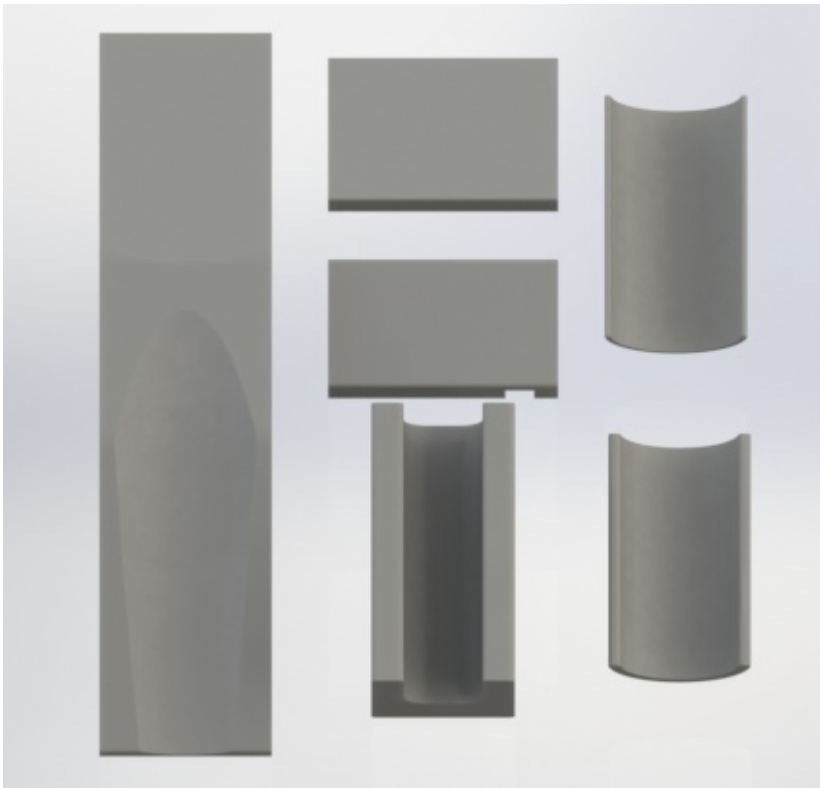

Patsiendi paigutamine

18ch T/R põlvemähis on ette nähtud vasaku või parema põlve skannimiseks patsiendil, kes lamab selili ja on lükatud magnetseadmesse, jalad ees.

1. Paigaldage mähis ja padjad enne patsiendi paigutamist. 18ch T/R põlvemähis tarnitakse erinevate patjadega, et pakkuda patsiendile suuremat mugavust. Allpool on toodud soovituslik paigutus:

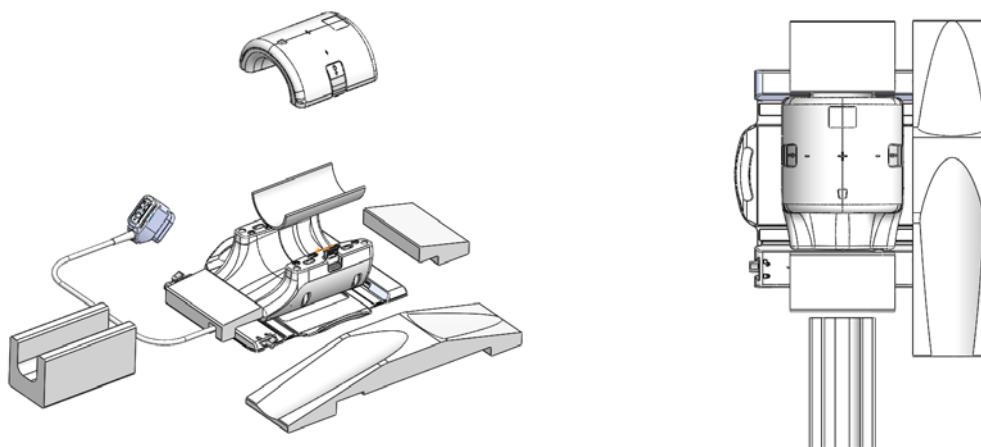

2. Paigutage patsiendi põlv mähise tagumise poole sisse. Patsiendi põlve korralikult liikumatuks muutmiseks ja patsiendi mugavuse tagamiseks tuleb kasutada asjakohaseid patju.



Mähise lukustamine


3. Sulgege mähis, veendudes, et te ei pigistaks mähise poolte vahele patsiendi nahka, kitlit ega voodipesu. See võib põhjustada patsiendi vigastuse, kujutise halva kvaliteedi või kahjustada mähist.

Mähise kaks poolt on kujundatud nii, et mähist saab sulgeda ainult õigesti suunatuna.



4. Kui eesmine pool on täielikult suletud, suruge riivi klapid mõlemal küljel alla vastu mähise pinda, et mehaanilised riivid täielikult sulgeda. Kui riivid ei ole täielikult suletud, võib mähis skannimise



ajal lahti tulla ja põhjustada kas ühenduse täielikku kadumist või vahelduvat ühendust mähise poolte vahel, mis annab tulemuseks halva kvaliteediga kujutise või kahjustab mähist.

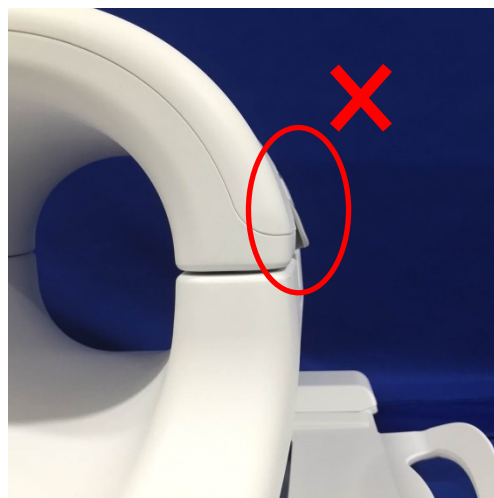

Ettevaatust! Olge ettevaatlik, et sõrmed ei satuks riivi alla. Hoidke kinni ainult juurdepääsetavatest klappidest, nagu on näidatud eespool oleval pildil.

Tähistamine

5. Lükake patsient magnetseadmesse ja tähistage mähis, kasutades võrdlusmärke, mis paiknevad 18ch T/R põlvemähise peal. Viige mähis avasse ja alustage uuringut.

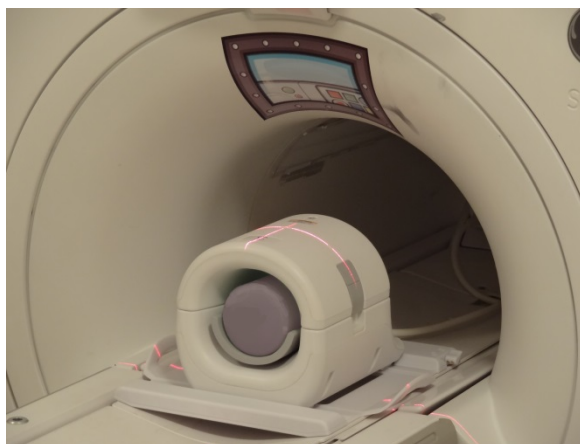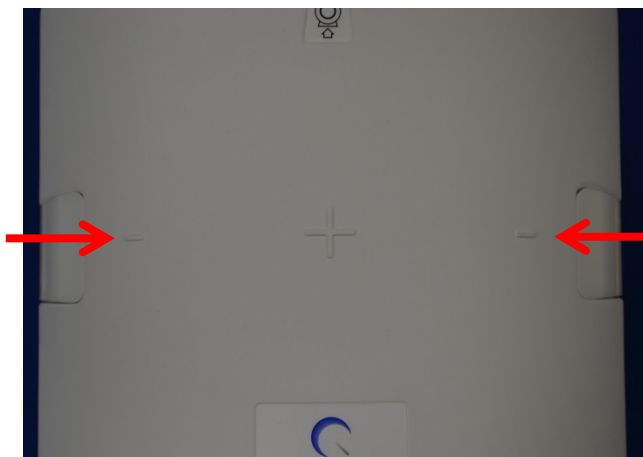

Peatükk 6 – Puhastamine, hooldus, teenindus ja kasutuselt kõrvaldamine

RF-mähise puhastamine

	Ettevaatust! Ärge kallake puhastuslahust otse mähisele ega lisatarvikutele.
	Ettevaatust! Ärge steriliseerige mähist ega lisatarvikuid.
	Ettevaatust! Ärge kandke elektrikontaktidele puhastuslahust.

RF-mähist ja patsiendi mugavust tagavaid patju tuleks puhastada pärast iga kasutust, kasutades järgmist protseduuri.

1. Ühendage RF-mähis enne mähise puhastamist MRT skannerist lahti.
2. Pühkige mähise pinnalt kuiva riidelapiga maha kogu mustus. Kui mustust on raske eemaldada, puhastage see allkirjeldatud protseduuride kohaselt.
3. Pühkige riidelapiga, mida on niisutatud lahuses, mis sisaldab 10% valgendit ja 70–99% isopropanooli või 70% etanooli.
4. Visake mis tahes mähise ja patjade puhastamiseks kasutatud materjalid ära kõikide föderaalsete, riiklike ja kohalike määruste kohaselt.
5. Mähiste pinnal võib kasutada ka üldiselt kättesaadavaid puhastusvahendeid. Vaadake juhiseid puhastusvahendite tootja kasutusjuhendist ja järgige tavapäraseid haiglaprotseduure.

Üksikasjalikud sammud puhastamisel

Puhastamiseelsed sammud

1. Tehke kõik pinnad märjaks vahendiga CaviCide (kasutades pihustit või salvrätte teatud pindade (nt elektrikontaktide lähedal olevate pindade) jaoks; ärge kandke puhastuslahust elektrikontaktidele). Veenduge, et kõik pinnad oleks nähtavalt märjad ja jääks märjaks vähemalt 30 sekundiks.
2. Kõvenenud või raskesti eemaldatava prahi või biokoormuse lahti saamiseks kasutage pehmet nailonharjastega harja ja/või täiendavaid puhastavaid salvrätte. Kandke täiendavalt puhastusvahendit (kasutades pihustit või salvrätte teatud pindade (nt elektrikontaktide lähedal olevate pindade) jaoks) piirkondadele, mida pühkisite enne harja või riidelapiga. Veenduge, et need enne harja või riidelapiga pühitud kohad jääksid puhastusvahendiga märjaks tehtult nähtavalt märjaks vähemalt 30 sekundiks.
3. Pühkige pinnad prahi eemaldamiseks puhaste pabersalvrätidega.

4. Visake ära kasutatud harjad, kasutatud puhastusvahendiga niisutatud salvrätid ja kasutatud pabersalvrätid.
5. Korrake samme 1 kuni 4.
6. Kui mustus jääb pindadele, korrake desinfitseerimiseelseid samme.

Puhastamise sammud

1. Kandke CaviCide (kasutades pihustit või salvrätte teatud pindade (nt elektrikontaktide lähedal olevate pindade) jaoks) otse eelpuhastatud pindadele ja veenduge, et kõik pinnad oleks nähtavalt märjad ja jääks märjaks vähemalt kaheks (2) minutiks. Ärge kandke elektrikontaktidele puhastuslahust.
2. Pühkige pinnad puhastusvahendi jääkide eemaldamiseks puhaste pabersalvrättidega.
3. Visake ära kasutatud puhastusvahendiga niisutatud salvrätid ja kasutatud pabersalvrätid.

Laske mähisel ja lisatarvikutel enne kasutamist ära kuivada.

Hooldus

RF-mähis ei vaja korrapärast planeeritud hooldamist.

Teenindus

Kui teil on küsimusi RF-mähise teenindamise kohta, pöörduge GE kohaliku esindaja poole.

Kasutuselt kõrvaldamine

Järgige kohalikke eeskirju elektriseadmete utiliseerimiseks. Ärge visake RF-mähist sorteerimata prügikastidesse. Kui teil on küsimusi RF-mähise tagastamise või kasutuselt kõrvaldamise kohta, pöörduge GE kohaliku esindaja poole.

SEE LEHEKÜLG ON JÄETUD TÜHJAKS TAHTLIKULT



Tootja:

Quality Electrodynamics, LLC.
6655 Beta Drive, Suite 100
Mayfield Village, OH 44143
USA

www.qualityelectrodynamics.com

Edasimüüja:

GE Medical Systems, LLC

Türgi importija andmed:

GE Medical Systems Turkey Ltd.
Sti. Esentepe Mah. Harman Sok. Nr: 8
34394 Sisli – Istanbul, Türki